



UA.TR.116

Виробник

ЛЕНСТЕК (БАРБАДОС) ІНК.
 Ейрпорт Комершел Сентр, Пілгрім Род,
 Крайст Чорч, Барбадос, ВВ17092
 Тел. +1 (246) 420-6795; факс: +1 (246)420-6797

Уповноважений
 представник
 виробника в Україні



ТОВ «ТЕХНОМЕДЕКС ГРУП»,
 вул.Сім'ї Сосніних, 11, м.Київ, 03134 Україна,
 Тел.(044) 501 40 70; Ел.пошта: tmx@tmx.kiev.ua

| | | | |
|---|---|--|--|
| | LENSTEC (BARBADOS) Inc. , Airport Commercial Centre, Pilgrim Road, Christ Church BB17092, Barbados | | |
| | +1 (246) 420-6795 | +1 (246) 420-6797 | lenstecbarbados@lenstec.com |
| | EC REP CMI spol. s. r.o. Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, Slovakia | | |
| | +421(2) 52631441 | +421 (2) 52922882 | lenstec@cmi.sk |
| UK SALES: LENSTEC (BARBADOS) Inc. , Lenstec House, Unit 8, Mariner Court, Calder Park, Wakefield, WF4, 3FL, UK | | | |
| +44 (0) 1924 382 678 | +44 (0) 1924 850 454 | lenstecuk@lenstec.com | |
| WORLD HEADQUARTERS: LENSTEC, Inc. , 1765 Commerce Ave N, Saint Petersburg, Florida 33716, U.S.A. | | | |
| +1 (727) 571-2272 | +1 (727) 571-1792 | lenstec@lenstec.com | |

REF SOFTEC HP1
 Інструкція з використання

- Виробник
- Представник виробника в ЕС
- Номер за каталогом
- Серійний номер
- Використати до
- Стерилізація етиленоксидом
- Ознайомтеся з інструкцією з використання
- Ознайомтеся з супровідними документами
- Тільки за призначенням лікаря
- Повторно використовувати заборонено
- Повторна стерилізація заборонена
- Заборонено використовувати якщо пакування пошкоджене
- Знак відповідності директивам ЄС

PKI30 UK Rev 1

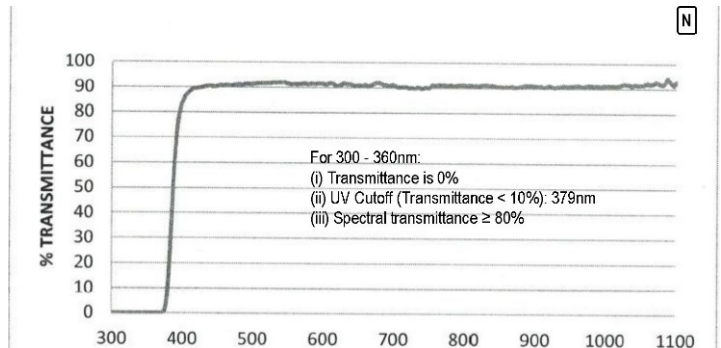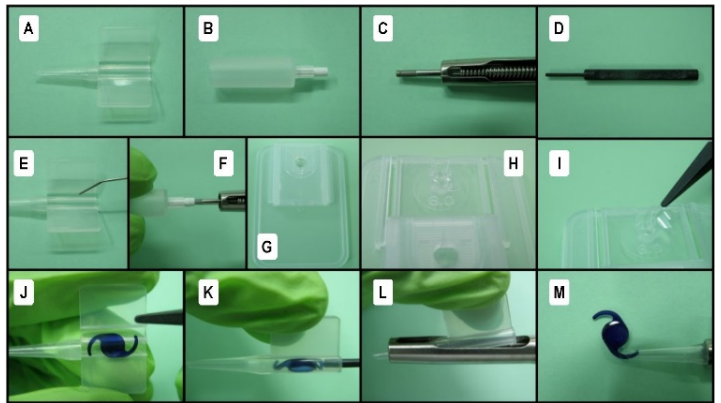

Дата останнього перегляду інструкції: 27.05.2019

PKI30 UK REV 1
 MASTER DATE 30 OCT 19

MASTER

| Powers (D) | Tolerances (D) | Increments (D) | Accessories |
|----------------|----------------|----------------|---|
| +10.0 to +14.5 | ±0.25 | 0.5 | <p> Reusable #0118 LC16 Car45S +10.0 to +26.0D </p> <p> Disposable Injectors LC16I Car45SI to +26.0D LC24 +10.0 to +36.0D </p> |
| +15.0 to +25.0 | ±0.11 | 0.25 | |
| +25.5 to +30.0 | ±0.25 | 0.5 | |

